SHENYUN

WWW.SYBARIATRIC.COM

# 2026

# Catálogo de productos

Dispositivos médicos de un solo uso y tubos de silicona de grado médico, diseñados y fabricados en Suzhou, China.

- Cirugía bariátrica
- Drenaje
- Cuidado de la incontinencia
- Catéteres




**Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.**

Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China

info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com


SGS · CE 1639 · FDA 510K · NMPA

# Índice

**Perfil de la empresa** 03

## 01 Cirugía bariátrica p. 4

Tubo de calibración gástrica estéril de un solo uso 05

Balón intragástrico 06

Sistema de cierre fascial 07

## 02 Drenaje p. 8

Tubos de drenaje de silicona 09

Set de drenaje por presión negativa 10

## 03 Cuidado de la incontinencia p. 11

Colector urinario externo masculino 12

Kit de manejo de la incontinencia fecal 13

## 04 Catéteres p. 14

Sondas urinarias de silicona 15

Mascarilla laríngea 16

Cánula de aspiración Yankauer 17

Tubo de silicona de grado médico 18



ACERCA DE SHENYUN

# Fabricante de dispositivos médicos de un solo uso certificado según ISO 13485, en Suzhou, cerca de Shanghái.

| 2020 | 100+ | 4,000 m² | 500,000 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| fundación | empleados | instalaciones con sala limpia | unidades al mes | países atendidos |



Producción en sala limpia



Control de calidad

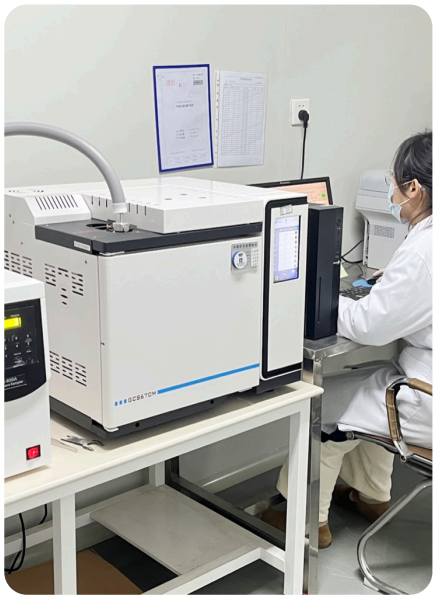

Laboratorio analítico

# 01

SERIE

# Cirugía bariátrica

Tubo de calibración gástrica estéril de un solo uso · Balón intragástrico · Sistema de cierre fascial

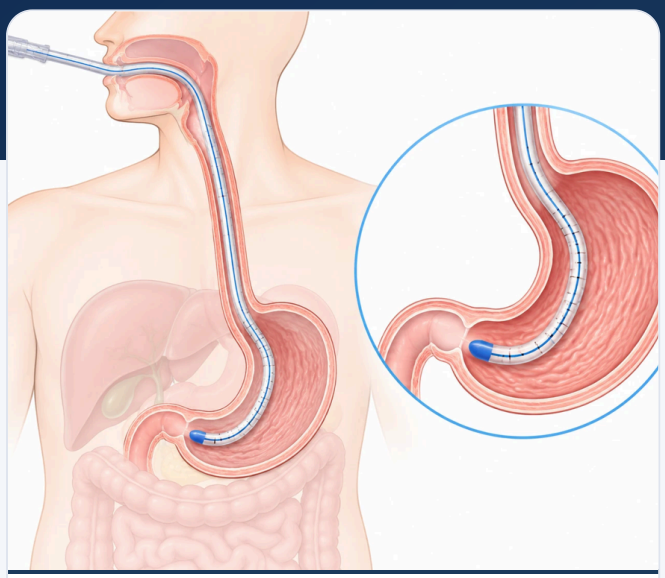

## Tubo de calibración gástrica estéril de un solo uso 05

Se coloca a lo largo de la curvatura menor para calibrar la manga

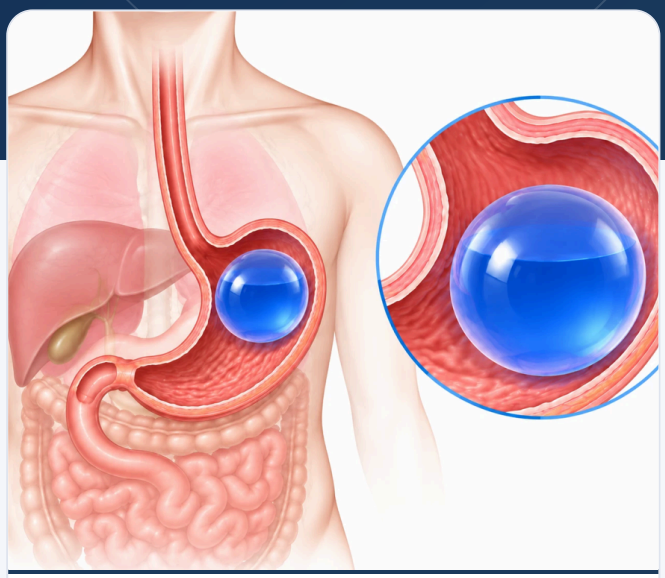

## Balón intragástrico 06

Balón llenado dentro del estómago

CIRUGÍA BARIÁTRICA · ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Tubo de calibración gástrica estéril de un solo uso

05

Tubo de calibración de silicona de grado médico para bypass gástrico mini y gastrectomía vertical, en versión estándar y versión con balón.

CE MDR Class IIa | Registro SFDA (Arabia Saudí) | ISO 13485:2016





**Tipo I · Estándar** · 32–40 Fr · 1.200 mm



**Tipo II · Con balón** · 32–40 Fr · 745 mm · balón de 30 mL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Silicona de grado médico, flexible y lisa
- Marcas de profundidad y línea radiopaca para el posicionamiento
- Conector cónico y conector universal para jeringas y aspiración
- Válvula unidireccional

## EMBALAJE



Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

**Tipo I · Estándar · longitud 1.200 mm**

| Modelo | Calibre | DE (mm) | DI (mm) |
|---|---|---|---|
| **SY01-04** | 32 Fr | 10.70 | 6.7 |
| **SY01-00** | 34 Fr | 11.30 | 7.1 |
| **SY01-01** | 36 Fr | 12.00 | 8.0 |
| **SY01-02** | 38 Fr | 12.40 | 8.4 |
| **SY01-03** | 40 Fr | 13.20 | 8.2 |

**Tipo II · Con balón · longitud 745 mm**

| Modelo | Calibre | DE (mm) | Balón |
|---|---|---|---|
| **SY02-04** | 32 Fr | 10.70 | 30 mL Ø 40 mm |
| **SY02-00** | 34 Fr | 11.30 | |
| **SY02-01** | 36 Fr | 12.00 | |
| **SY02-02** | 38 Fr | 12.40 | |
| **SY02-03** | 40 Fr | 13.20 | |

ENDOSCOPIA BARIÁTRICA · ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Balón intragástrico

Balón intragástrico de silicona no ajustable, colocado y retirado por vía endoscópica, con un periodo máximo de permanencia de 6 meses.

ISO 13485

06



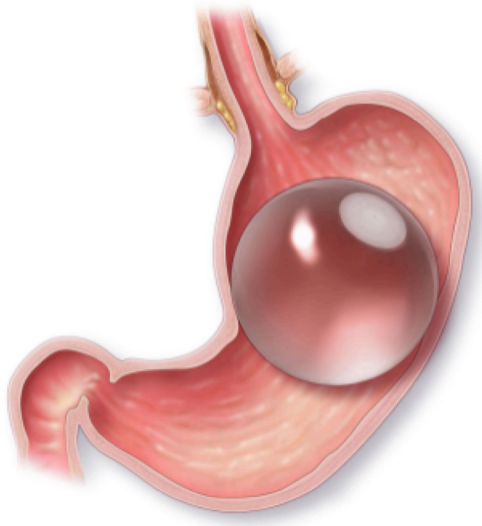

**Balón lleno** · 400–700 mL de solución salina con azul de metileno



**Contenido del kit** · con jeringa de 100 mL

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Modelo** | SY08-01 |
| **Material** | Silicona de grado médico |
| **Volumen de llenado** | 400–700 mL de solución salina (con azul de metileno) |
| **Periodo de permanencia** | Máximo 6 meses; debe retirarse, puede sustituirse |
| **Diámetro de la sonda** | 6 ± 0,2 mm |
| **Kit** | Balón con válvula antirretorno, sonda de colocación de silicona con funda, guía de acero, tubo de llenado, jeringa de 100 mL |
| **Esterilidad** | Estéril, un solo uso |
| **Retirada** | Endoscópica: punción para desinflar y extracción con pinza de agarre |

## EMBALAJE



Envase unitario

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE**

Solo para uso por médicos cualificados en centros sanitarios. Se suministra únicamente a distribuidores, hospitales y centros bariátricos, no a particulares. El balón debe retirarse a más tardar 6 meses después de su colocación. Los resultados individuales varían y no se garantiza una pérdida de peso determinada. Consulte las instrucciones de uso para conocer la lista completa de contraindicaciones, advertencias y posibles complicaciones. Los pacientes deben contactar inmediatamente con su médico en caso de cambio de color de la orina, dolor abdominal persistente, vómitos intensos, distensión abdominal o dificultad respiratoria.

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA · ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Sistema de cierre fascial

07

Trocar laparoscópico con dos canales de sutura integrados y un pasador de sutura: acceso y cierre del orificio del trocar con un solo dispositivo.

FDA 510(k) K260197 | ISO 13485:2016






**Trocar y pasador de sutura**



**Contenido del kit** · trocar, pasador de sutura, accesorios opcionales

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Dos canales de sutura a 180° para cerrar la fascia a través de la cánula
- Líneas de profundidad azul y negra en la cánula para colocar correctamente la sutura
- Obturador óptico para la entrada bajo visión directa con laparoscopio de 0°, u obturador sin cuchilla
- La válvula autosellante mantiene el neumoperitoneo al retirar los instrumentos; sello extraíble para la extracción de piezas

## EMBALAJE




Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

| REF | Obturador | Calibre | Longitud |
|---|---|---|---|
| **1018S** | Óptico | 10 mm | 110 mm |
| **1218S** | Óptico | 12 mm | 110 mm |
| **1518S** | Óptico | 15 mm | 110 mm |
| **1018B** | Sin cuchilla | 10 mm | 110 mm |
| **1218B** | Sin cuchilla | 12 mm | 110 mm |
| **1518B** | Sin cuchilla | 15 mm | 110 mm |

| | |
|---|---|
| **Trocar** | Cánula con sello, llave de insuflación y canales de sutura; obturador |
| **Pasador de sutura** | Aguja con mordazas de pulsador y marca de dirección |
| **Opcional** | Aguja de Veress, bolsa de extracción |

# 02

SERIE

# Drenaje

Tubos de drenaje de silicona · Set de drenaje por presión negativa

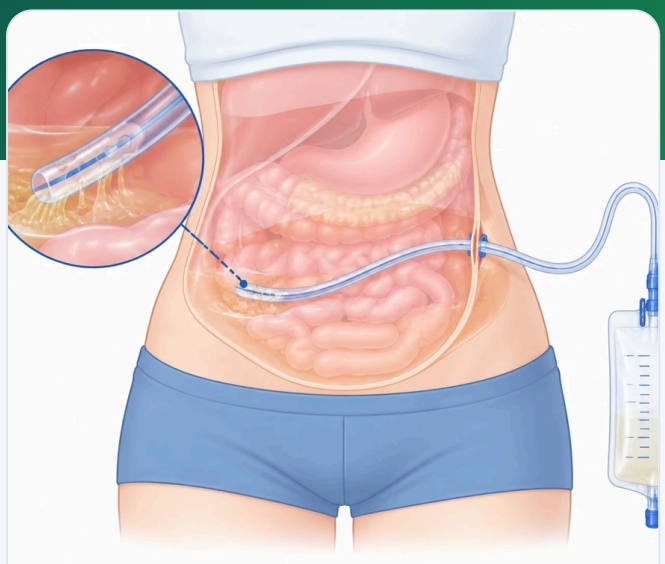

## Tubos de drenaje de silicona 09

Drenaje posoperatorio de la cavidad abdominal



## Set de drenaje por presión negativa 10

Drenaje cerrado de heridas con pera de vacío

DRENAJE QUIRÚRGICO · ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Tubos de drenaje de silicona

Tubos de drenaje de silicona de grado médico en cinco diseños, para el drenaje postoperatorio de heridas y cavidades corporales.

ISO 13485 | CE MDR Clase IIa (10–26 Fr) | Registro FDA (exento de 510(k))



**Redondo**



**En cruz**



**Espiral (antiobstrucción)**



**Plano**



**En T**

DRENAJE

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Silicona de grado médico al 100 %, suave y flexible
- Cinco diseños: redondo, en cruz, espiral, plano y en T; 8–26 Fr
- Perfiles en cruz y espiral con múltiples canales de drenaje; el diseño en espiral ayuda a evitar obstrucciones
- Estéril (OE), un solo uso

## EMBALAJE




Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

**Redondo · longitud 900 mm**

| Código | Calibre | DE × DI (mm) | Modelo CE |
|---|---|---|---|
| CP-1621 | 10 Fr | 3.3 × 1.6 | SY03-01 |
| CP-1622 | 12 Fr | 4.0 × 2.1 | SY03-02 |
| CP-1623 | 14 Fr | 4.7 × 2.6 | SY03-03 |
| CP-1624 | 15 Fr | 5.0 × 2.9 | — |
| CP-1625 | 16 Fr | 5.3 × 3.2 | SY03-04 |
| CP-1626 | 18 Fr | 6.0 × 3.5 | SY03-05 |
| CP-1627 | 19 Fr | 6.3 × 3.7 | — |
| CP-1628 | 20 Fr | 6.7 × 4.1 | SY03-06 |
| CP-1629 | 22 Fr | 7.3 × 4.7 | SY03-07 |
| CP-1630 | 24 Fr | 8.0 × 5.4 | SY03-08 |

**En T (sin marcado CE)**

| Código | Calibre | DE × DI (mm) |
|---|---|---|
| CP-1631 | 12 Fr | 4.0 × 2.4 |
| CP-1632 | 18 Fr | 6.0 × 3.8 |

DRENAJE QUIRÚRGICO · ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Set de drenaje por presión negativa

Set de drenaje cerrado de heridas que combina un tubo de drenaje de silicona con una pera de vacío, aguja guía y bolsa de drenaje, en cuatro configuraciones.

ISO 13485



**Tipo IV** · tubo de drenaje, aguja guía, pera de vacío y bolsa de drenaje



**Pera de vacío** · 100 / 200 mL



**Aguja guía**



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de drenaje cerrado
- Tubo de drenaje de silicona de grado médico, 8–24 Fr
- Pera de vacío transparente con escala de volumen y válvula antirreflujo unidireccional
- Peras con salida superior o inferior

## EMBALAJE



Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

| | Tubo de drenaje | Conector | Aguja guía | Pera de vacío | Bolsa de drenaje |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo I** | • | • | | • | |
| **Tipo II** | • | | • | | |
| **Tipo III** | • | • | • | • | |
| **Tipo IV** | • | • | • | • | • |

| | |
|---|---|
| **Tubo de drenaje** | Silicona, 8–24 Fr; redondo, en cruz, espiral, plano o en T (véase la ficha del tubo de drenaje) |
| **Pera de vacío** | CP-0129 · 100 mL, salida superior<br>CP-0130 · 100 mL, salida inferior<br>CP-0128 · 200 mL, salida superior<br>CP-0127 · 200 mL, salida inferior |
| **Aguja guía** | Para colocar el tubo de drenaje a través de la piel |
| **Bolsa de drenaje** | 500 / 1,000 mL |

# 03

SERIE

# Cuidado de la incontinencia

Colector urinario externo masculino · Kit de manejo de la incontinencia fecal



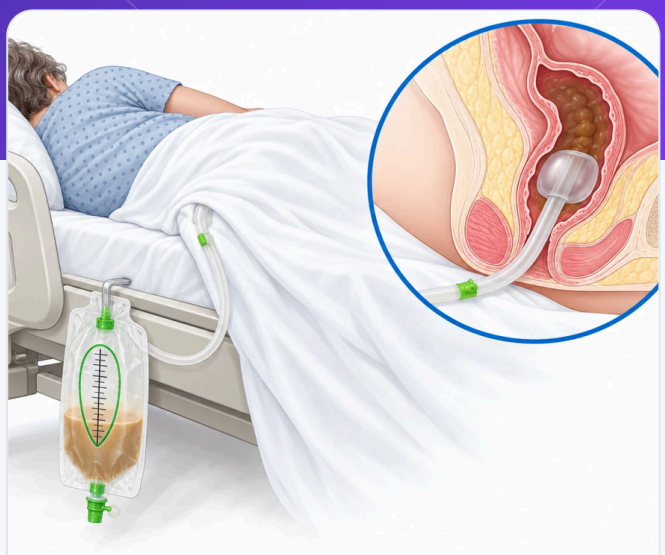

**Colector urinario externo masculino** 12

Bolsa de pierna de día y bolsa de cama de noche

**Kit de manejo de la incontinencia fecal** 13

Manejo fecal cerrado para pacientes encamados

UROLOGÍA E INCONTINENCIA · NO INVASIVO · NO ESTÉRIL

# Colector urinario externo masculino

12

Funda de silicona autoadhesiva y sin látex para la recogida externa de orina en hombres, en tres modelos y siete tallas.

**ISO 13485** | **CE Clase I (autodeclarado, EUDAMED)** | **Registro FDA (exento de 510(k))**



**Siete tallas** · 18–41 mm




**Bolsas de orina compatibles** · bolsa de pierna de 500 mL / bolsa de cama de 2000 mL



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Silicona de grado médico, sin látex
- Autoadhesivo para una sujeción segura
- Funda transparente para revisar la piel sin retirarla
- Tres modelos: Pop On, Standard y Wide Band

## EMBALAJE




Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

| Modelo / talla (mm) | 18 | 20 | 25 | 29 | 32 | 36 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pop On** | SY06-01 | SY06-02 | SY06-03 | SY06-04 | SY06-05 | SY06-06 | SY06-07 |
| **Standard** | SY06-08 | SY06-09 | SY06-10 | SY06-11 | SY06-12 | SY06-13 | SY06-14 |
| **Wide Band** | SY06-15 | SY06-16 | SY06-17 | SY06-18 | SY06-19 | SY06-20 | SY06-21 |

CUIDADO DE LA INCONTINENCIA · NO ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Kit de manejo de la incontinencia fecal

13

Sistema cerrado para la recogida y el drenaje de heces líquidas o semilíquidas en pacientes encamados y de UCI.

ISO 13485 | CE Clase I (autodeclarado, EUDAMED)

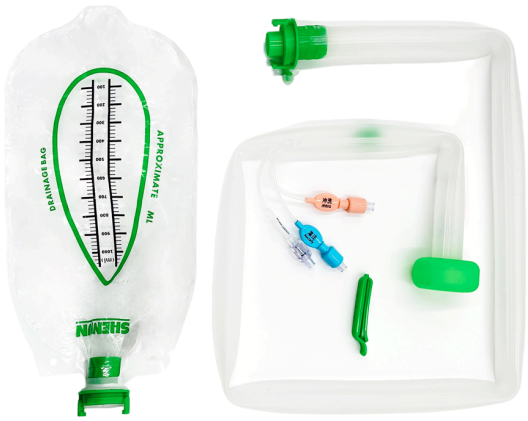


**Contenido del kit** · tubo de drenaje y bolsas colectoras




**Bolsa colectora** · graduada

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema cerrado que ayuda a contener olores y fugas
- Balón de retención, llenado con hasta 45 mL de solución salina
- Puerto de irrigación para lavado e instilación
- Línea indicadora de posición para comprobar la colocación

## EMBALAJE




Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| **SY-FB-01** | Tubo de drenaje, 1.200 mm, con balón de retención y puerto de irrigación |
| **SY-FB-02** | Bolsa colectora, 1.000 mL |
| **Kit** | 1 tubo de drenaje + 2 bolsas colectoras |

# 04

SERIE

# Catéteres

Sondas urinarias de silicona · Mascarilla laríngea · Cánula de aspiración Yankauer · Tubo de silicona de grado médico

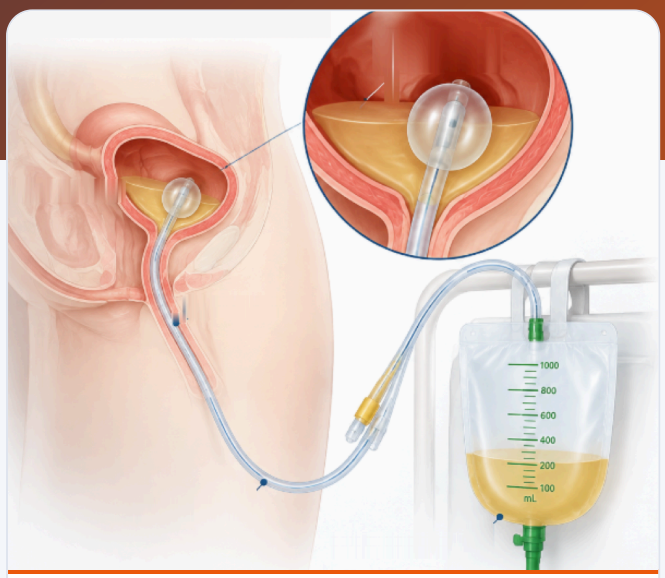


**Sondas urinarias de silicona** 15
El balón mantiene el catéter en la vejiga

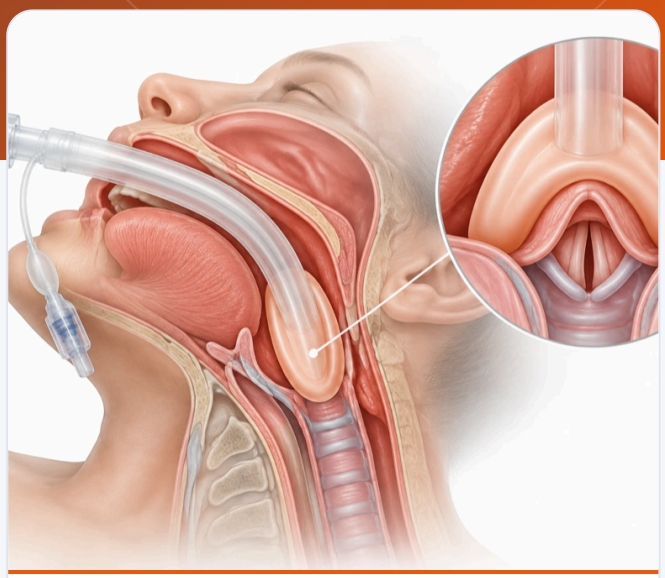

**Mascarilla laríngea** 16
La mascarilla sella la entrada laríngea

UROLOGÍA · ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Sondas urinarias de silicona

Sondas urinarias 100 % silicona, sin látex: Foley de 2 y 3 vías y Nelaton.

ISO 13485 | CE MDR Class IIa



**Foley de 2 vías** · 8–26 Fr



**Foley de 3 vías** · 18–30 Fr, con luz de irrigación

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 100 % silicona, sin látex
- Balón de retención en Foley de 2 y 3 vías
- Foley de 3 vías con luces separadas de drenaje, balón e irrigación
- Nelaton en longitud pediátrica (250 mm) y estándar (400 mm)

## EMBALAJE




Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

| Tipo | Modelos | Calibres | Balón / longitud |
|---|---|---|---|
| **Foley de 2 vías** | SY03-08 – SY03-26 | 8–26 Fr | 3–5 mL (8–12 Fr) · 5–10 mL (14–24 Fr) · 30 mL (26 Fr) |
| **Foley de 3 vías** | SY03-18T – SY03-30T | 18–30 Fr | 5–10 mL / 30 mL |
| **Nelaton** | SY04-06 – SY04-24 | 6–24 Fr | Longitud 250 mm (pediátrica) / 400 mm (estándar) |

ANESTESIA Y VÍA AÉREA · ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Mascarilla laríngea

Dispositivo supraglótico para anestesia y manejo urgente de la vía aérea, con manguito inflable o no inflable.

ISO 13485



Gama de mascarillas laríngeas

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Versiones con manguito inflable y no inflable
- Tubo de vía aérea con conector para máquinas de anestesia y ventiladores
- Línea de inflado con válvula antirretorno (versiones inflables)
- Ocho tallas, de neonato a adulto

## EMBALAJE




Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

| Modelo | Calibre | Inflado máx. del manguito | Paciente | Peso del paciente (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **SY10-01** | 1.0 | 4 mL | Neonato | < 5 |
| **SY10-02** | 1.5 | 7 mL | Lactante | 5–10 |
| **SY10-03** | 2.0 | 10 mL | Lactante | 10–20 |
| **SY10-04** | 2.5 | 14 mL | Niño | 20–30 |
| **SY10-05** | 3.0 | 20 mL | Niño | 30–50 |
| **SY10-06** | 4.0 | 30 mL | Adulto | 50–70 |
| **SY10-07** | 5.0 | 40 mL | Adulto | 70–100 |
| **SY10-08** | 6.0 | 50 mL | Adulto | > 100 |

ASPIRACIÓN · NO ESTÉRIL · UN SOLO USO

# Cánula de aspiración Yankauer

Cánula de aspiración rígida con tubo de conexión, para la aspiración oral y faríngea y la limpieza del campo quirúrgico.

ISO 13485



Cánula de aspiración con tubo de conexión



Cánula de aspiración Yankauer

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Punta estándar o corona, con o sin orificio de control
- Cánula y tubo transparentes para controlar visualmente el flujo
- Tubo de conexión de 1/4″ o 3/16″ de diámetro interior, de 1,8 m o 2,1 m de longitud
- Cánula: K-resin · tubo de conexión: PVC

## EMBALAJE



Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

| Modelo | Punta | DI del tubo | Longitud |
|---|---|---|---|
| **SY09-01** | Punta corona, con orificio de control | 1/4″ | 1.8 m |
| **SY09-02** | Punta corona, con orificio de control | 1/4″ | 2.1 m |
| **SY09-03** | Punta corona, con orificio de control | 3/16″ | 2.1 m |
| **SY09-04** | Punta corona, sin orificio de control | 1/4″ | 1.8 m |
| **SY09-05** | Punta corona, sin orificio de control | 1/4″ | 2.1 m |
| **SY09-06** | Punta corona, sin orificio de control | 3/16″ | 2.1 m |
| **SY09-07** | Punta estándar, con orificio de control | 1/4″ | 1.8 m |
| **SY09-08** | Punta estándar, con orificio de control | 1/4″ | 2.1 m |
| **SY09-09** | Punta estándar, con orificio de control | 3/16″ | 2.1 m |
| **SY09-10** | Punta estándar, sin orificio de control | 1/4″ | 1.8 m |
| **SY09-11** | Punta estándar, sin orificio de control | 1/4″ | 2.1 m |
| **SY09-12** | Punta estándar, sin orificio de control | 3/16″ | 2.1 m |

TUBO DE SILICONA · CURADO CON PLATINO · MEDIDAS A MEDIDA

# Tubo de silicona de grado médico

Tubo de silicona de grado médico curado con platino en 31 medidas estándar, con dimensiones a medida disponibles.

ISO 13485

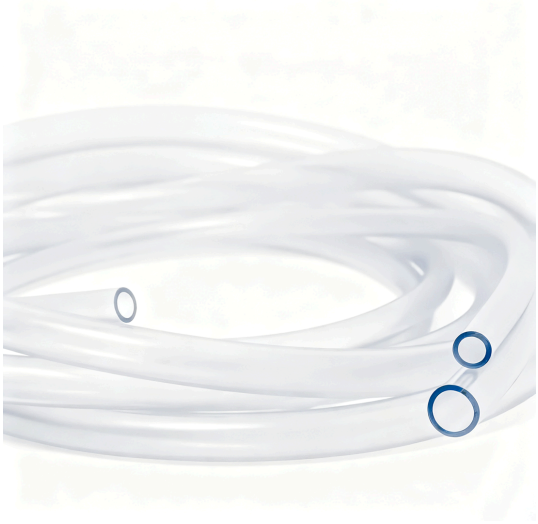

**Tubo de silicona** · suministrado en rollos

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Silicona de grado médico curada con platino
- No tóxica y de baja alergenicidad
- Resiste la desinfección a alta temperatura
- 31 medidas estándar: DI 0,5–12,0 mm, DE 1,3–18,5 mm

## EMBALAJE




Envase unitario

## ESPECIFICACIONES

| REF | ID | OD |
|---|---|---|
| MST-001 | 0.5 | 1.3 |
| MST-002 | 1.6 | 3.2 |
| MST-003 | 2.0 | 4.0 |
| MST-004 | 2.5 | 4.8 |
| MST-005 | 2.5 | 5.0 |
| MST-006 | 3.0 | 4.0 |
| MST-007 | 3.0 | 5.0 |
| MST-008 | 3.0 | 6.0 |
| MST-009 | 4.0 | 6.0 |
| MST-010 | 4.0 | 7.0 |
| MST-011 | 4.0 | 8.0 |
| MST-012 | 5.0 | 8.0 |
| MST-013 | 5.0 | 9.0 |
| MST-014 | 5.0 | 10.0 |
| MST-015 | 6.0 | 8.0 |
| MST-016 | 6.0 | 9.0 |

| REF | ID | OD |
|---|---|---|
| MST-017 | 6.0 | 10.0 |
| MST-018 | 6.0 | 11.0 |
| MST-019 | 6.0 | 12.0 |
| MST-020 | 6.5 | 11.0 |
| MST-021 | 7.0 | 10.0 |
| MST-022 | 7.0 | 11.0 |
| MST-023 | 7.0 | 12.0 |
| MST-024 | 7.0 | 13.0 |
| MST-025 | 8.0 | 11.5 |
| MST-026 | 8.0 | 12.0 |
| MST-027 | 8.0 | 12.8 |
| MST-028 | 9.0 | 13.0 |
| MST-029 | 9.5 | 14.6 |
| MST-030 | 10.0 | 14.0 |
| MST-031 | 12.0 | 18.5 |




# Colabore con SHENYUN

**OEM y marca propia**
Su marca en cajas y etiquetas

**Distribuidores**
Cooperación con importadores y distribuidores regionales

**Muestras**
Muestras gratuitas de determinados productos

**Cotizaciones**
FOB Shanghái en USD, validez de 30 días

La certificación varía según el producto y se indica en su página. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso; contáctenos para obtener la versión más reciente.

SHENYUN

**Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd.**
Building 11, No. 666 Yinzang Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China
info@symedical.com.cn · www.sybariatric.com
Tel / WhatsApp +86 151 5045 7575 · +86 512 6520 9633